INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO Y MANUAL DEL USUARIO

1. Perfore 2 tornillos en la puerta con las herramientas y el plano provisto en esta página de manera que la parte inferior del dispositivo quede aproximadamente 12 pulgadas (30 cm) de distancia de la parte superior de la manija de la puerta.
2. Monte el dispositivo en los dos tornillos. Asegúrese de que encaje con firmeza. Apretar o aflojar los tornillos si es necesario

O

3. Coloque la cinta adhesiva doble en la parte posterior del dispositivo. Asegúrese que la superficie de la puerta esté limpia y seca. Remueva las franjas de protección de la cinta adhesiva, coloque dispositivo en la posición correcta y presione firmemente contra la puerta.
4. No es necesario utilizar la cinta y los tornillos al mismo tiempo, escoja uno de los dos.

MODO DE ARMAR SU DISPOSITIVO

PASO 1: Remover el seguro del dispositivo, quitar la llave. Presione el botón a un lado del dispositivo para poder abrirlo.

PASO 2: Sitúe el interruptor de Encendido / Apagado (1) en la posición Apagado. Instalar 3 baterías AA.

PASO 3: Modo de operación.

a. DÍA/24H (2): DÍA = El dispositivo funcionará solo cuando hay luz presente. 24H = El dispositivo funcionará las 24 horas del día.

MICRO tiene un detector de luz (5). Activo solo cuando el dispositivo esté situado en la opción día.

b. 15/30/60 (3) : El dispositivo pulveriza cada 15, 30 o 60 minutos.

PASO 4: Instale el cartucho de repuesto. Haga una prueba de rociado.

a. Abra la tapa del alojamiento de la lata. Presione la cerradura y levante la tapa.

b. Instale un cartucho de repuesto. Cerrar la tapa y cerciórese de escuchar un clic.

c. Sitúe el interruptor de Encendido / Apagado (1) en la posición Encendido. La pantalla LCD encenderá una luz roja (6) que parpadeará por un segundo.

d. Cerrar la cubierta frontal, asegurar el dispositivo. Saque la llave y manténgala en un lugar seguro.

e. Después de 5 segundos, el dispositivo rociará una vez, *aun si hay alguien en el área de rociado.*

SENSOR DE MOVIMIENTO

El dispositivo tiene un sensor de movimiento para detener una rociada accidental en la mano de alguien. Si alguien se encuentra en el área de rociado al momento del rociado, una luz roja (6) empezará a parpadear. El dispositivo no rociará hasta después de 5 segundos de que el área de rociado esté libre. Este ciclo de 5 segundos continuará hasta que el dispositivo detecte que el área de rociado está libre, luego se llevará a cabo el rociado.

LCD

La pantalla LCD muestra el voltaje de la pila y el nivel de la lata.

Indicador de voltaje de la pila (7a): Para que el dispositivo funcione correctamente, el indicador de voltaje de la pila = 3 barras. Si el indicador muestra 2 barras y luego 1, es necesario cambiar las pilas lo más pronto posible. Si muestra 0 barras, LAS PILAS DEBEN CAMBIARSE DE INMEDIATO. El dispositivo todavía podrá rociar aerosol, pero no tendrá voltaje para rociar suficiente fórmula en la manija de la puerta y eliminar las bacterias de manera eficaz. Una vez que se hayan instalado pilas nuevas, el indicador = 3 barras.

Nivel de la lata de repuesto (7b): La lata de repuesto llena (min. 800 atomizaciones) debe mostrar 7 barras. Luego de 100 rociadas una barra desaparece. Cuando solo queden 100 rociadas, la imagen de la lata aparecerá vacía. Después de 50 rociadas más, la luz roja parpadea continuamente (6) y continúa parpadeando hasta instalar una lata nueva. El sistema se restaura pulsando continuamente el botón de reinicio (4) por unos 3 segundos.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En caso de que el dispositivo no esté rociando, compruebe lo siguiente:

¿Está vacía la lata de repuesto? Para cambiar el cartucho:

a. Sitúe el interruptor de Encendido / Apagado (1) en la posición Apagado.

b. Abra la tapa del alojamiento de la lata. Presione el seguro y levante la tapa.

c. Instale una lata nueva de aerosol.

d. Cambie el intervalo de tiempo (2), (3) si lo desea.

e. Sitúe el interruptor de Encendido / Apagado (1) en la posición Encendido.

f. Presione el botón de reinicio (4) por 3 segundos. La imagen de la lata de repuesto (7b) debe mostrar 7 barras.

g. Cierre y asegure el dispositivo.

¿Es necesario cambiar las pilas? Si la imagen de la pila aparece vacía y parpadea, LAS PILAS DEBEN CAMBIARSE DE INMEDIATO. Asegúrese de utilizar pilas nuevas; usar pilas de buena calidad incrementa la eficiencia del sistema y la vida útil de las pilas.

¿Es posible efectuar una prueba de atomización? Usted puede realizar una prueba de rociado cuando lo desee. Presione RESET (4) durante 1 segundo. El dispositivo rociará una vez incluso si alguien se encuentra en el área de rociado.

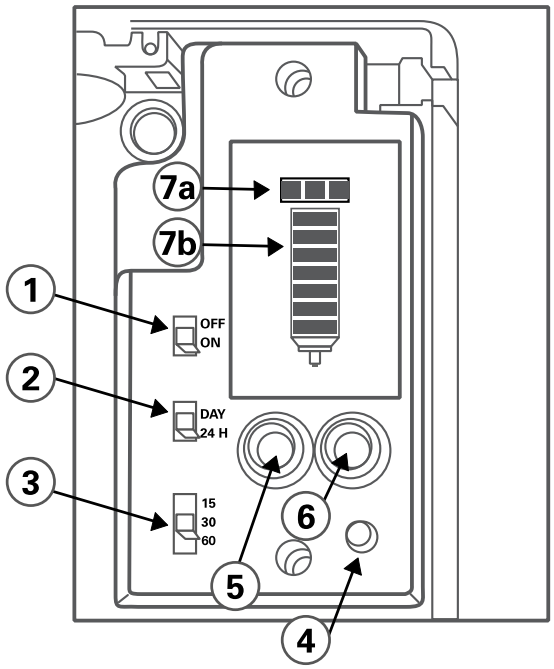

Información adicional sobre desinfección de superficies para consumidores en los Estados Unidos: Sugerimos la instalación del sistema desinfectante automático para pomos de puertas dispositivo en los siguientes lugares: puertas de baños públicos, hospitales, aulas escolares, spas, teatros, cocinas y guarderías infantiles.

Sugerencias para una instalación óptima: Instalar la unidad de dosificación automática dispositivo de 6 a 12 pulgadas sobre una superficie de contacto intenso (pomo, perilla o palanca). Para desinfectar adecuadamente, la unidad de dosificación automática dispositivo debe estar centrada de manera que la superficie quede completamente humedecida por el aerosol desinfectante. Solo la zona humedecida por el aerosol desinfectante quedará desinfectada.

La unidad de dosificación automática dispositivo puede ser graduada manualmente para atomizar en intervalos de 15, 30 o 60 minutos. El intervalo está determinado por el tráfico del lugar donde el dosificador está instalado. Dependiendo de la superficie (pomo, perilla o palanca) donde el dosificador esté instalado, cerciórese de que esté en una posición en la que la manija de la puerta reciba la máxima humedad. El aerosol es liberado de forma cónica y la unidad debe estar colocada correctamente para lograr mejores resultados. Una vez que la posición ha sido determinada, fijar el dispensador a la puerta con la cinta adhesiva de montaje o los tornillos suministrados. Consulte las instrucciones de instalación en la plantilla adjunta.

Instrucciones adicionales de instalación: Instale la unidad de dosificación automática dispositivo de 6 a 12 pulgadas sobre el pomo, perilla o palanca de la puerta y elija un intervalo de tiempo de 15, 30 o 60 minutos entre atomizaciones. La unidad dosificará un ligero rociado de desinfectante registrado ante la EPA que cubrirá toda el área accesible. La fórmula de secado rápido desinfectará la superficie húmeda en 10 minutos. Cada lata continuará atomizando desinfectante por 7 a 30 días dependiendo del intervalo.

Declaraciones adicionales: La fórmula desinfectante dispositivo es un desinfectante de uso hospitalario registrado ante la Administración de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA). Se ha comprobado que este desinfectante es eficaz contra las siguientes bacterias: Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus resistente a la meticilina (MRSA). También se ha comprobado que es efectivo contra los siguientes virus: Rinovirus, virus de la influenza A2, Norovirus, Calicivirus felino y contra el hongo T. mentagrophytes (hongo del pie de atleta). La fórmula desinfectante HYSO ha demostrado que elimina el 99.9% de estas importantes bacterias, virus y hongos.

Kimberly-Clark PROFESSIONAL*

Exceptional Workplaces*